

DATAMARK LU201/SU201

有線 LAN 地震計

VissQ ビスキュー
計測地震防災システム

本カタログの内容は計測地震防災システム
VissQ (ビスキュー) での使用を前提に
しています。



LAN ケーブルで電源も供給。簡便で安価な地震計。

▶ データマーク LU201/SU201 は LAN 接続の地震計です。観測システムは、A/D コンバータ内蔵のセンサ部 SU201 と記録部 LU201 とで構成され、1 台の記録部に対して最大 10 台のセンサ部を接続することができます。また、センサ部の電源は、PoE^{*}にて供給されるので、設置を簡便に行うことができます。

特長

▶ LAN ケーブル 1 本で電源も供給


LU201/SU201 は、直接 LAN 接続が可能で、PoE^{*}の受電機能によりセンサ部 SU201 は、共に LAN ケーブル 1 本で電源の供給まで行えます。電源工事のわずらわしさがなく、設置作業もスムーズです。

▶ 高性能で低価格を実現

LU201/SU201 により、強震観測用途に使用可能な高性能地震観測システムを安価に構築できます。

▶ 複数センサ間が時刻同期

記録部 LU201 を介して、複数のセンサ部 SU201 が時刻同期して計測するので、絶対時刻に高い精度で同期した計測も可能です。

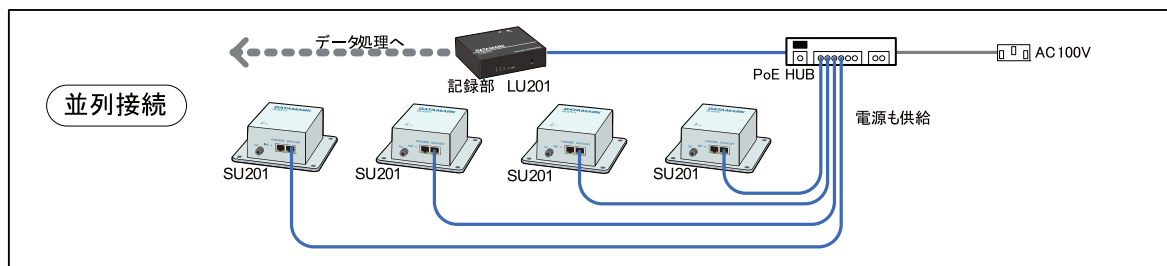

^{*} PoE (Power over Ethernet) Ethernet の配線ケーブル (カテゴリ 5 以上のツイストペアケーブル) を利用して電力を供給する技術 (IEEE 802.3af 規格)。

▼主な仕様

記録部 LU201		
センサ部接続台数	最大 10 台	
トリガ	トリガセンサ台数	最大 10 台
	トリガ論理	センサ間 OR/AND、センサ内 OR
	プリトリガ時間	1~99 秒
	ポストトリガ時間	1~99 秒
	トリガ継続時間	1~30 秒
	トリガレベル	0~980Gal, 1Gal 単位
通信プロトコル	HTTP・FTP・NTP	
CPU	RMI Alchemy Au1500(400MHz)	
MEMORY	128MB	
FLASH ROM	32MB	
NIC	10BASE-T/100BASE-TX ×1 10BASE-T/100BASE-TX ×1 (PoE 受電: TypeA/Bに対応)	
内蔵 Storage	標準 512Mbyte	
電源	DC5V/2.3A	
スイッチ	INIT	
表示・警告	ステータス LED ×3 電源 LED ×1 LAN アクセス LED	
消費電力	10W	
動作環境	温度	0~40℃ (PoE 受電時) *AC アダプタ使用時: 5~37℃
	湿度	25~85%Rh (結露しないこと)
寸法・重量	111 × 124 × 34mm、約 435g	
本体材質	アルミ合金製	
防水性	なし	


センサ部 SU201		
センサ	静電容量式加速度センサ	
周波数範囲	0.1~50Hz	
チャンネル数	3 チャンネル (水平 2 成分、鉛直 1 成分)	
A/D コンバータ	デルタシグマ型 24 ビット A/D コンバータ	
測定レンジ	±1.5G	
測定インターバル	10msec	
分解能	0.01Gal (水平/鉛直)	
通信プロトコル	HTTP・NTP クライアント	
通信インターフェイス	100BASE-TX ×2 適合コネクタ: RJ45 コネクタ 適合ケーブル: Ethernet UTP カテゴリ 5 以上の8芯ケーブル (最大 100m)	
電源	PoE 給電対応スイッチによる電源供給 (IEEE802.3af Power over Ethernet 規格の給電側(PSE (Power Sourcing Equipment))に準拠するもの、給電タイプ B を推奨)	
消費電力	単体動作時 2.6W カスケード接続時 3.6W	
動作環境	温度	-10~+50℃
	湿度	20~80%Rh (結露しないこと)
寸法・重量	140×140×58mm、約 650g	
防水性	なし	

※センサ部には防水タイプもあります。
 その他天井取り付け金具等のオプション品もあります。
 ※推奨 PoE HUB BUFFALO 社製 BS-POE-2008MR (給電タイプ B)
 ※計測に絶対時刻の精度が必要な場合には、別途 NTP サーバが必要です。
 ※本仕様は計測地震防災システム - VissQ (ビスキュー) での使用を前提としています。

▼標準付属品

記録部 LU201 用 AC アダプタ、記録部 LU201 用ゴム足、CD-R (ユーザーズマニュアル)、保証書

▼システム構成例

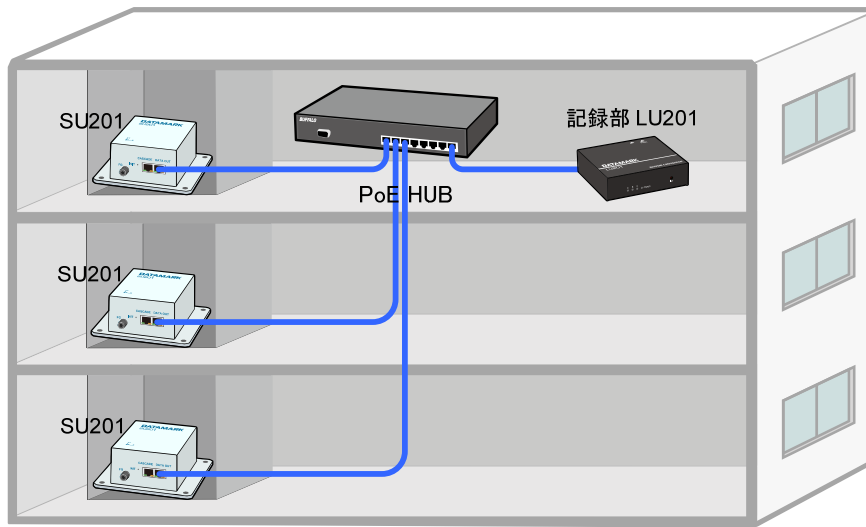

※図は概要を示すため、省略して描かれています。

ご不明点・ご質問は担当営業またはサポートにお問い合わせください。

注)本機を正しくより安全にご使用いただくため、ご使用の際には必ず「取扱説明書」または注意書きをよくお読みください。
 ※ DATAMARK®は白山工業株式会社の登録商標です。BUFFALO は、株式会社バッファローの商標です。その他の商標、登録商標は各所有者に帰属します。
 ※ このカタログに記載された仕様・デザインは予告なしに変更することがあります。
 ※ このカタログの記載内容は 2011 年 9 月 12 日現在のものです。

白山工業株式会社

〒183-0044 東京都府中市日鋼町 1-1 Jタワー10F
 TEL 042-333-0080 FAX 042-333-0096
 URL: <http://www.hakusan.co.jp/>
 E-mail: support@hakusan.co.jp

■お問い合わせは…